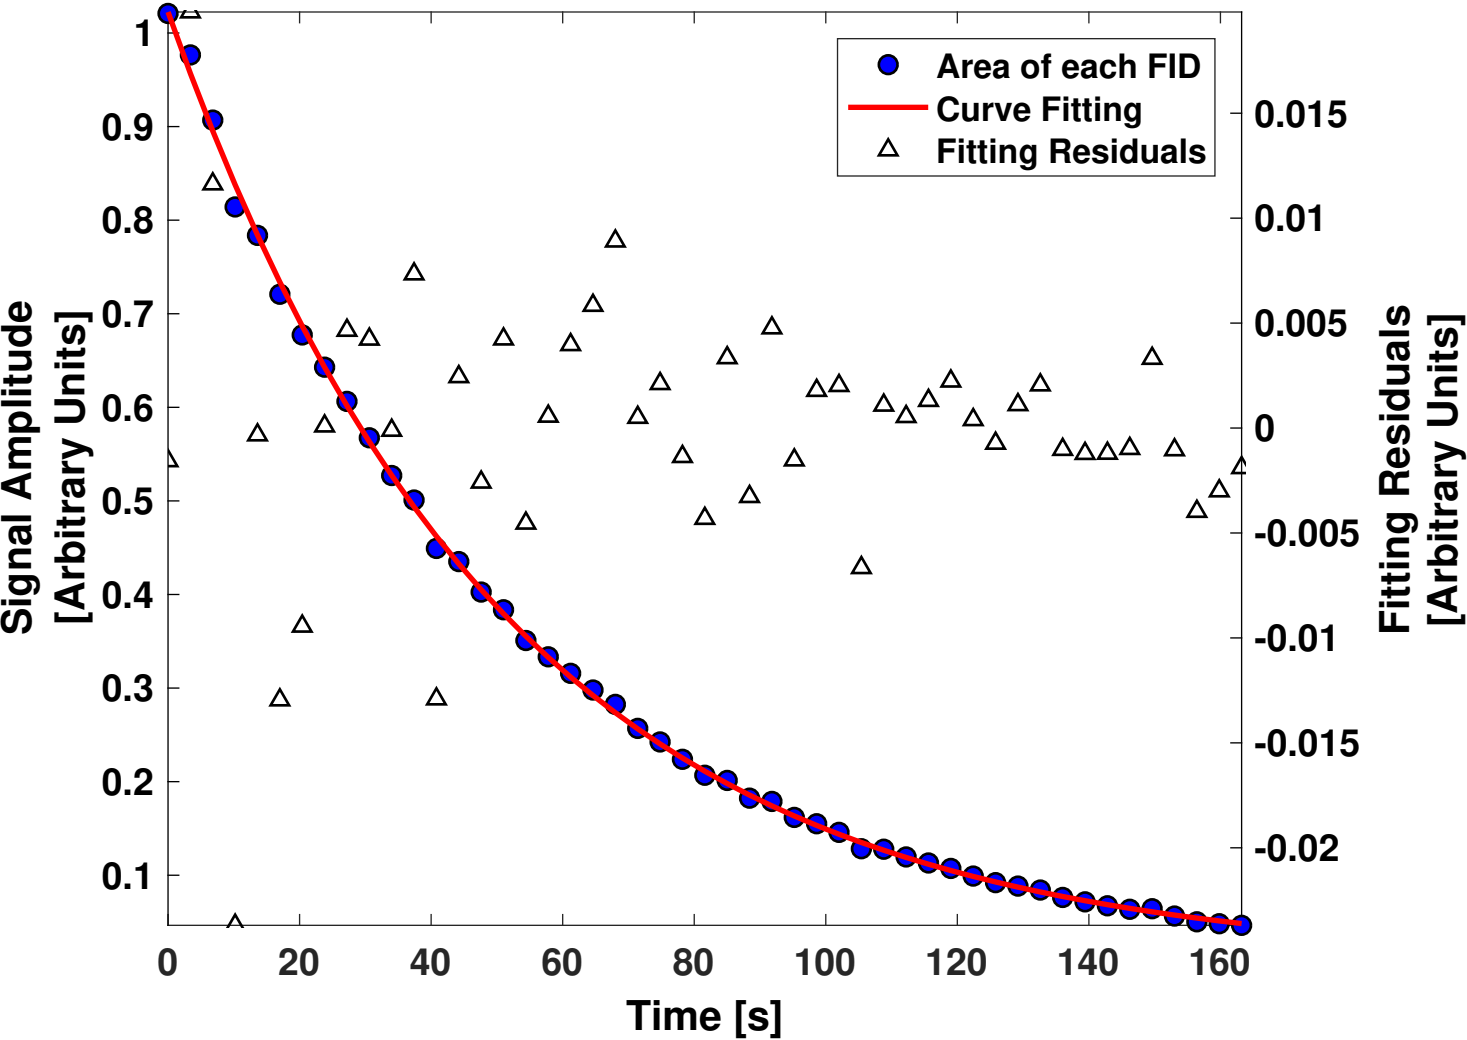
Area of each FID
Curve Fitting
Fitting Residuals
Signal Amplitude [Arbitrary Units]
Fitting Residuals [Arbitrary Units]
Time [s]
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.015
0.01
0.005
0
-0.005
-0.01
-0.015
-0.02
0
20
40
60
80
100
120
140
160